


# COVID-VIRO ALL IN DUO® et TRIPLEX®

## Mode opératoire\*



1

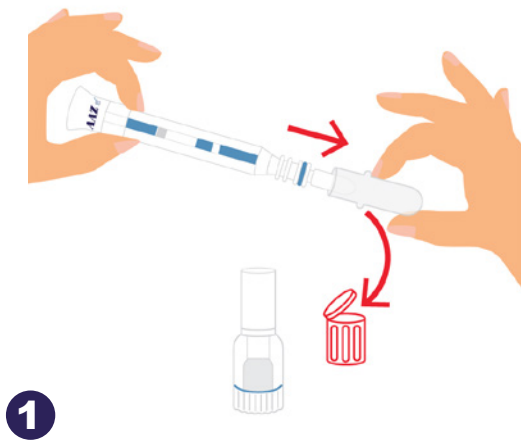

2

Tournez le test 15'' dans une narine




3




Tournez le test 15'' dans l'autre narine



4

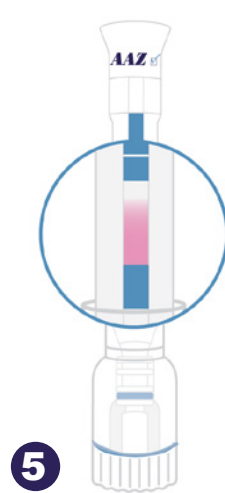

5

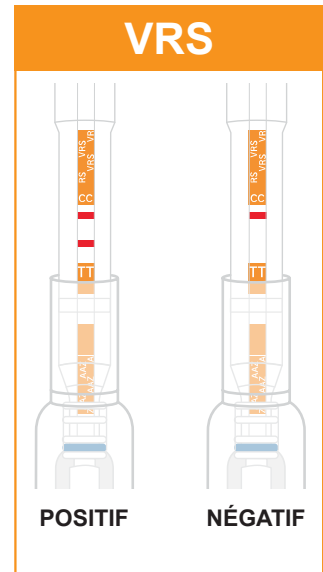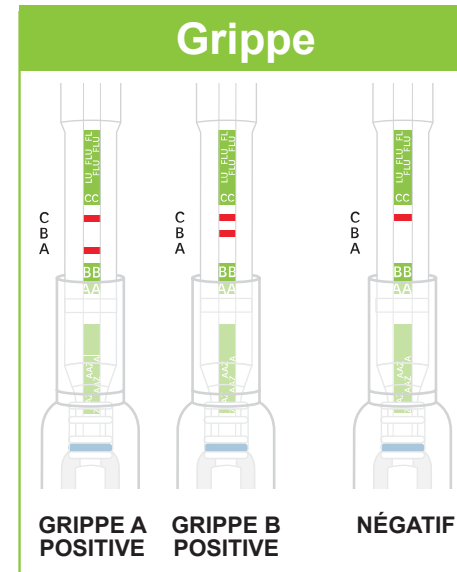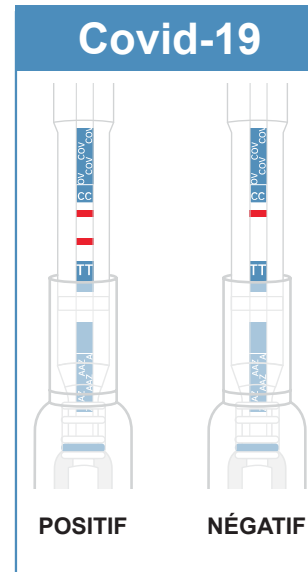

VIDÉO DE DÉMONSTRATION :



\*Lire intégralement la notice d'utilisation avant la réalisation du premier TROD