

Désignation	Référence	Code EAN
COV-GRIP - AAZ	TR-COG-001	3770011742073

Numéro de Lot	Date de péremption
2502065	31/01/2027

Procédure de test

La procédure du test a été réalisée conformément à la notice d'utilisation - référence : AAZ.CG.09-A (20201022)

Contrôle des performances

Un échantillon négatif (fig.1), un échantillon positif COVID (fig.2) et un échantillon positif grippe (fig.3) ont été testés.

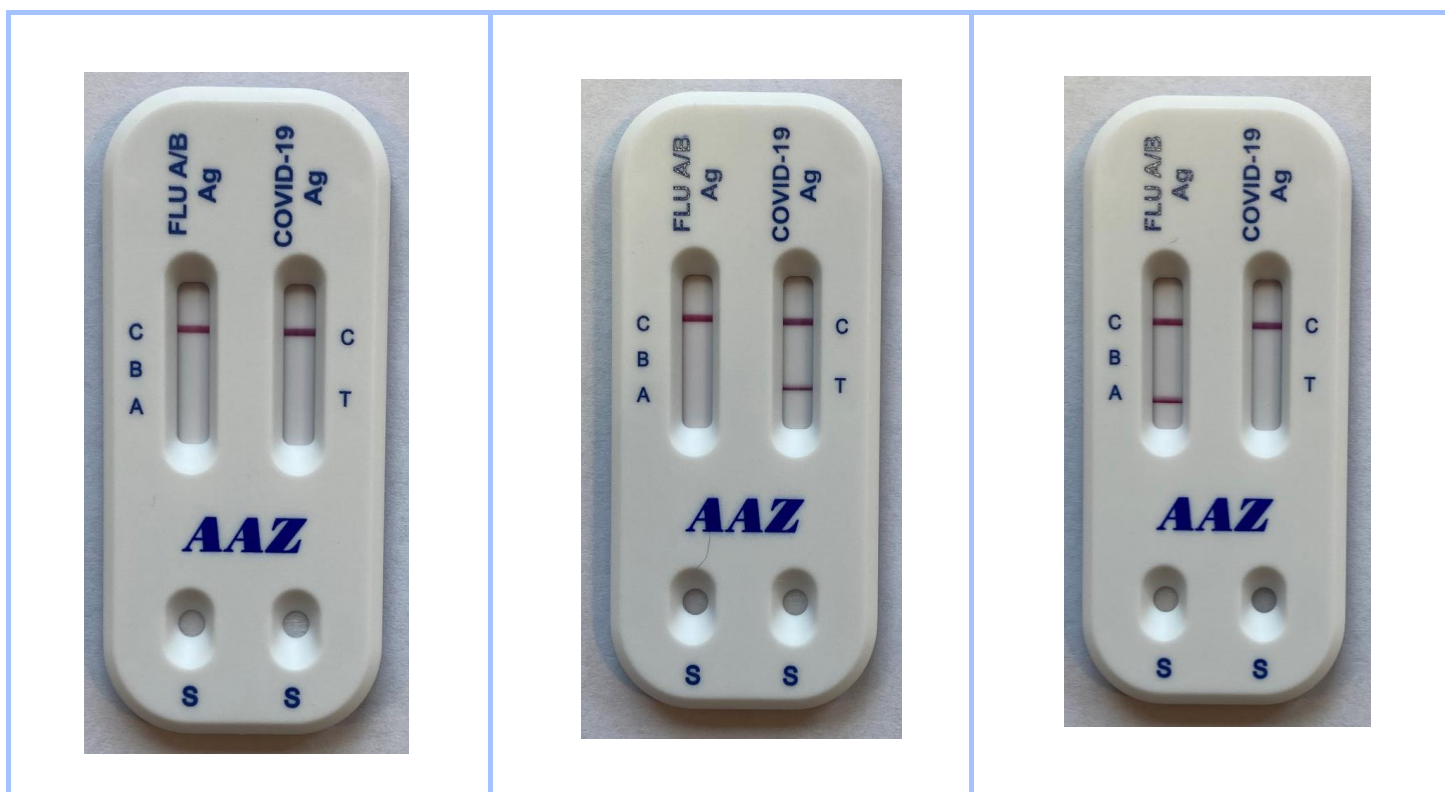


Figure 1. Echantillon négatif.

Figure 2. Echantillon positif COVID.

Figure 3. Echantillon positif grippe.

Conclusion

Les résultats du contrôle du lot 2502065 sont conformes.

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
 Service de Biochimie/Biochimie automatisée et de l'Urgence
 Hôpital Cochin, APHP

Date

03/12/2025

Dr Camille CHENEVIER-GOBEAUX
 Praticien Hospitalier
 Service de Diagnostic Biologique Automatisé
 Hôpital Cochin - APHP
 Tél. : 01 58 41 19 10 / Fax : 01 58 41 31 94
 camille.gobeaux@aphp.fr

Signature et Tampon